PROFESSIONAL MEASURING
SINCE 1844

KERN


Broszura produktowa

05.09.2026

# KERN KFD 600V20M

Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, lakierowany

POLSKI

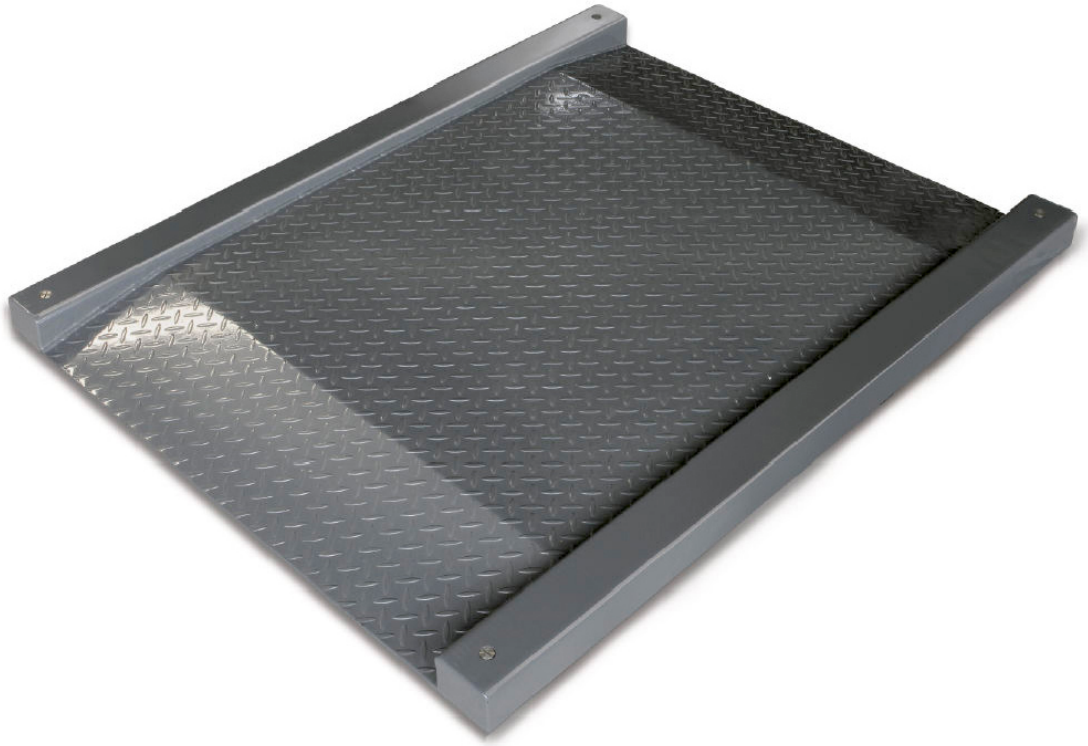

## KONTAKT

**KERN & SOHN GmbH**
**Ziegelei 1**
**72336 Balingen**
**Niemcy**

**+49 7433 9933-0**
**info@kern-sohn.com**
**www.kern-sohn.com**

## CECHY

- Pomost wagowy z antypoślizgowej stalowej blachy ryflowanej, lakierowany, dwie zintegrowane rampy najazdowe, wyjątkowo odporny na zginanie
- Wyjątkowo niski, umożliwia najazd bez przeszkód: wysokość najazdu tylko 45 mm
- 4 czujniki tensometryczne, stal stopowa, powlekane silikonem, IP67, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e

## DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.×gł.×wys. 1600×1220×95 mm, stal, malowana proszkowo
- Kabel łączący ok. 5 m
- Waga netto ok. 130 kg



## PIKTOGRAMY

Standard




Fabrycznie




## PRZEGLĄD MODELI

| Model | Zakres ważenia | Działka odcz. | Działka legaliz. | Obc. min. | Długość kabla | Wymiary Szalka | Waga netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [Max] | [d] | [e] | [Min] | | | ok. |
| KFD 600V20LM | 600 kg | 200 g | 200 g | 4 kg | 5 m | 1200×1200 mm | 165 kg |
| KFD 600V20M | 600 kg | 200 g | 200 g | 4 kg | 5 m | 1000×1000 mm | 130 kg |
| KFD 1500V20LM | 1500 kg | 500 g | 500 g | 10 kg | 5 m | 1200×1200 mm | 165 kg |
| KFD 1500V20M | 1500 kg | 500 g | 500 g | 10 kg | 5 m | 1000×1000 mm | 130 kg |

## AKCESORIA

| Model | Opis |
|---|---|
| BFS-A06N | Para stóp BFS-A06N |

## USŁUGI

| Model | Opis |
|---|---|
| 963-130 | Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-130 |
| 965-230 | Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-230 |

| Model | Opis |
|---|---|
| 965-413 | Montaż komponentów 965-413 (> 350 kg – 1500 kg) |
| 970-108 | Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-108 |

# Przegląd piktogramów KERN

| | |
|---|---|
|  | Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67 |
|  | Platforma: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67 |
|  | Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni |
|  | Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze |