


Broszura produktowa

08.08.2026

KERN KFP 6000V20M

Pomost wagowy ze stali

POLSKI

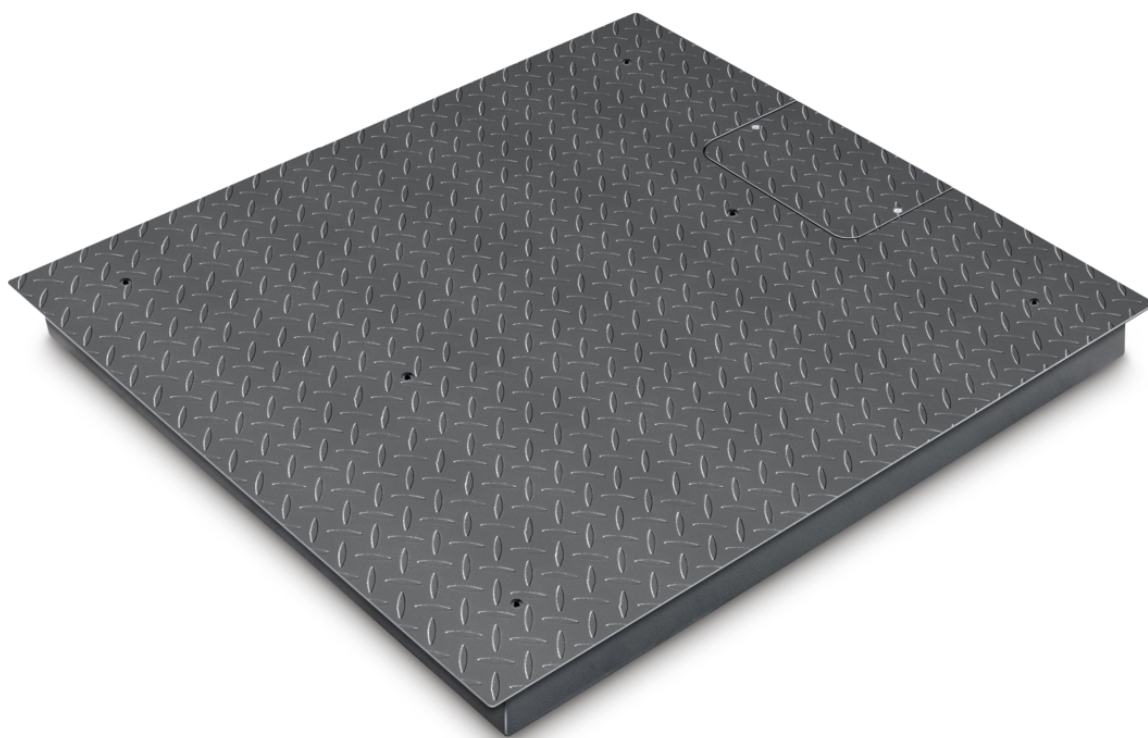

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

CECHY

- Pomost wagowy ze stalowej blachy ryflowanej. Wyjątkowo odporny na zginanie dzięki dużej grubości materiału
- 4 czujniki tensometryczne, stal, powlekane silikonem, IP67, dopuszczenie OIML-R60 do legalizacji, klasa III, 3000 e
- Możliwość zabudowy dzięki ramie fundamentowej (opcjonalnie)
- Poziomnica i śruby nóżek do dokładnego poziomowania wagi w standardzie
- Wygodny dostęp do skrzynki Junction-Box od góry
- Wygodne poziomowanie pomostu wagowego od góry

DANE TECHNICZNE

- Wymiary platformy wagowej szer.xgł.xwys. 1500×1500×123 mm, stal, malowana proszkowo
- Kabel łączący ok. 5 m
- Waga netto ok. 225 kg

PIKTOGRAMY

Standard

Fabrycznie



PRZEGLĄD MODELI

Model	Zakres ważenia	Działka odcz.	Działka legaliz.	Obc. min.	Długość kabla	Wymiary Szalka	Waga netto ok.
	[Max]	[d]	[e]	[Min]			
KFP 600V20NM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 600V20SNM	600 kg	200 g	200 g	4 kg	5 m	1000×1000 mm	95 kg
KFP 1500V20NM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 1500V20SNM	1500 kg	500 g	500 g	10 kg	5 m	1000×1000 mm	100 kg
KFP 3000V20LNM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1500 mm	175 kg
KFP 3000V20NM	3000 kg	1 kg	1 kg	20 kg	5 m	1500×1250 mm	150 kg
KFP 6000V20M	6000 kg	2 kg	2 kg	40 kg	5 m	1500×1500 mm	225 kg

AKCESORIA

Model	Opis
BFS-A10	Para stóp BFS-A10
BFS-A11	Rampa najazdowa BFS-A11 (1500×750×120 mm)

USŁUGI

Model	Opis
963-132	Świadectwo wzorcowania DAkkS 963-132
965-232	Legalizacja / ocena zgodności wg NAWI (2014/31/UE) 965-232
965-415	Montaż komponentów 965-415 (> 2900 kg - 6000 kg)
970-110	Przedłużenie gwarancji (+ 2 lata) 970-110

Przegląd piktogramów KERN



Platforma: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Czujnik tensometryczny: ochrona przed pyłem i bryzgami wody IP67



Wysyłka paletowa spedycją: Czas wewnętrznego przygotowania produktu wynosi dwa dni



Ocena zgodności: Czas oceny zgodności wynosi 3 dni robocze